
VALIDATED
DEVICE
LISTING

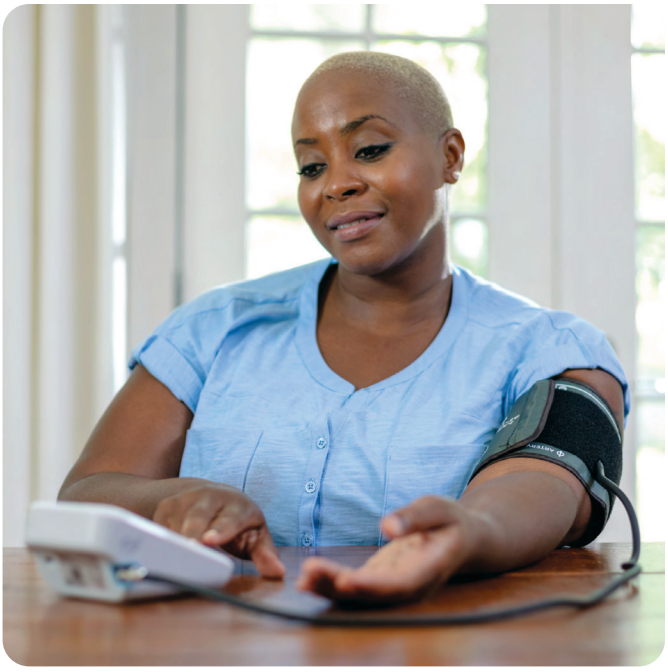

Blood pressure monitors you can trust.

It can be hard to know which monitors can be trusted to provide accurate information.

Getting accurate blood pressure readings at home should be simple and reliable. And it can be.

Find blood pressure monitors that are validated for clinical accuracy on the VDL™.

Check the current list of validated monitors here.

Every monitor listed on the VDL has completed an independent review process and is shown to be accurate. The VDL is a public health initiative led by the American Medical Association.


Learn more at ValidateBP.org.

The VDL is a list of BP devices that have been validated for clinical accuracy. Inclusion on this list means the device has met the VDL Criteria and the manufacturer agreed to be listed. All determinations are made by the Independent Review Committee and are not in any way determined or influenced by the AMA. The AMA does not receive funding from any device manufacturer or other third party in relation to the development of the VDL Criteria or VDL review process.

©2025 American Medical Association. All rights reserved.
IH025-0019 Updated 9/25.

A public health service supported by AMA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

LISTA DE DISPOSITIVOS VALIDADOS

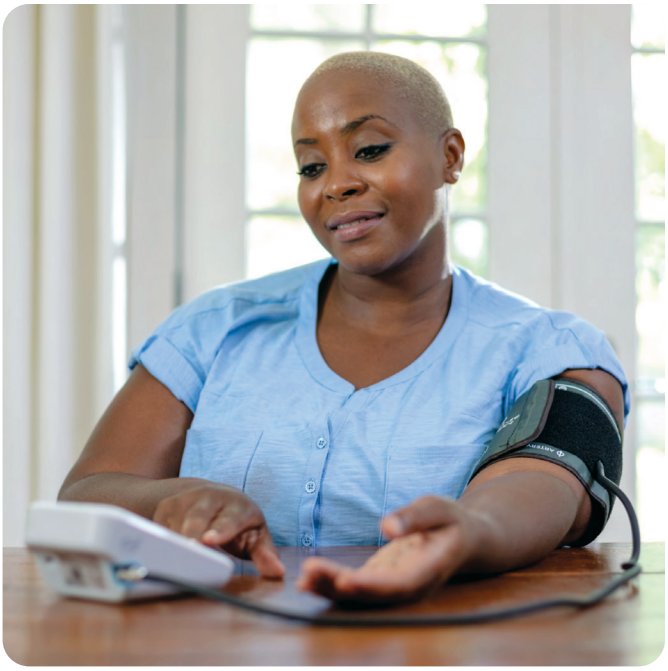

Monitores de presión arterial en los que puede confiar.

Saber en qué monitores se puede confiar para brindar información precisa puede ser difícil.

Obtener lecturas exactas de la presión arterial en el hogar debe ser sencillo y confiable. Y puede serlo.

Busque monitores de presión arterial en la VDL™ que estén validados por su precisión clínica.

Consulte la lista actual de monitores validados aquí.

Todos los monitores enumerados en la VDL han completado un proceso de revisión independiente y se ha demostrado que son exactos. La VDL es una iniciativa de salud pública dirigida por la American Medical Association.

Obtenga más información en ValidateBP.org.

La VDL es una lista de dispositivos para la presión arterial que han sido validados por su precisión clínica. El hecho de que un dispositivo esté en esta lista significa que ha cumplido con los criterios de la VDL y que el fabricante aceptó ser incluido en la lista. Todas las determinaciones son realizadas por el Comité de Revisión Independiente (Independent Review Committee) y no están de ninguna manera determinadas ni influenciadas por la AMA. La AMA no recibe financiamiento de ningún fabricante de dispositivos u otro tercero en relación con el desarrollo de los criterios de VDL o el proceso de revisión de la VDL.

©2025 American Medical Association. Todos los derechos reservados.
IH025-0019 Actualizado en 9/25

Un servicio de salud pública respaldado por la AMA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION